



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**US.C.34.004.A № 48668**

**Срок действия до 08 ноября 2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Измерители сопротивления изоляции Fluke 1550C и Fluke 1555**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма Fluke Corporation, США**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **51690-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

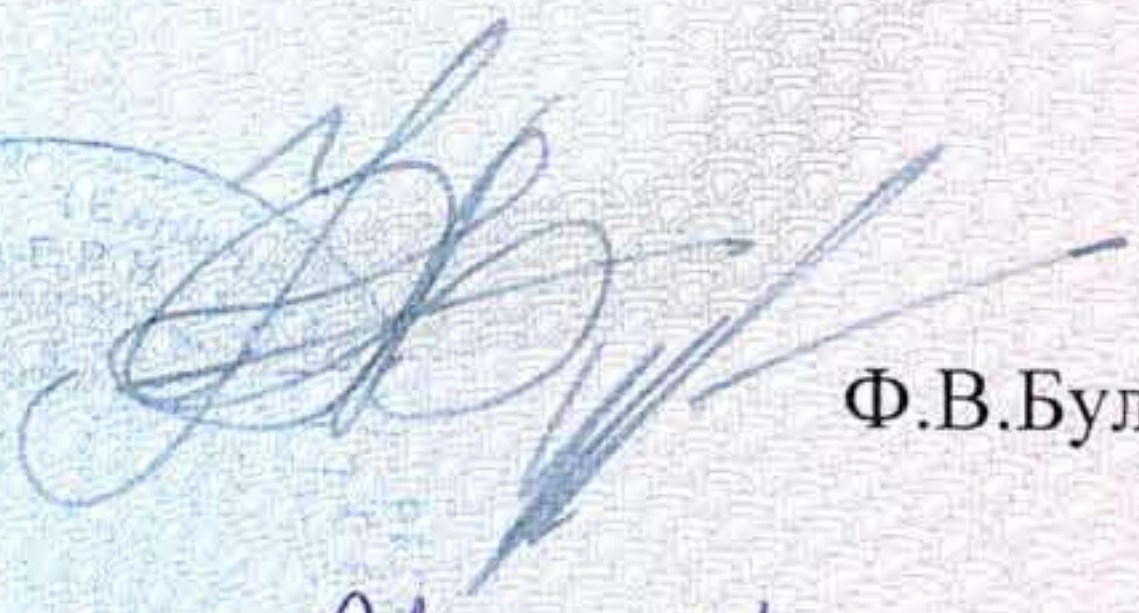
**МП 51690-12**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **08 ноября 2012 г. № 982**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Ф.В.Булыгин

"21" ..... 11 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 007297